Lagerungskeil unregelmäßig

Schaumstoff: RG35/43
Kunstleder in Ausführung:
Standard: elektrisch ableitfähig, schwarz
Röntgen/CT/MRT: **nicht** elektr. ableitfähig, hellgrau
Klett-/Flausch-Verschluss

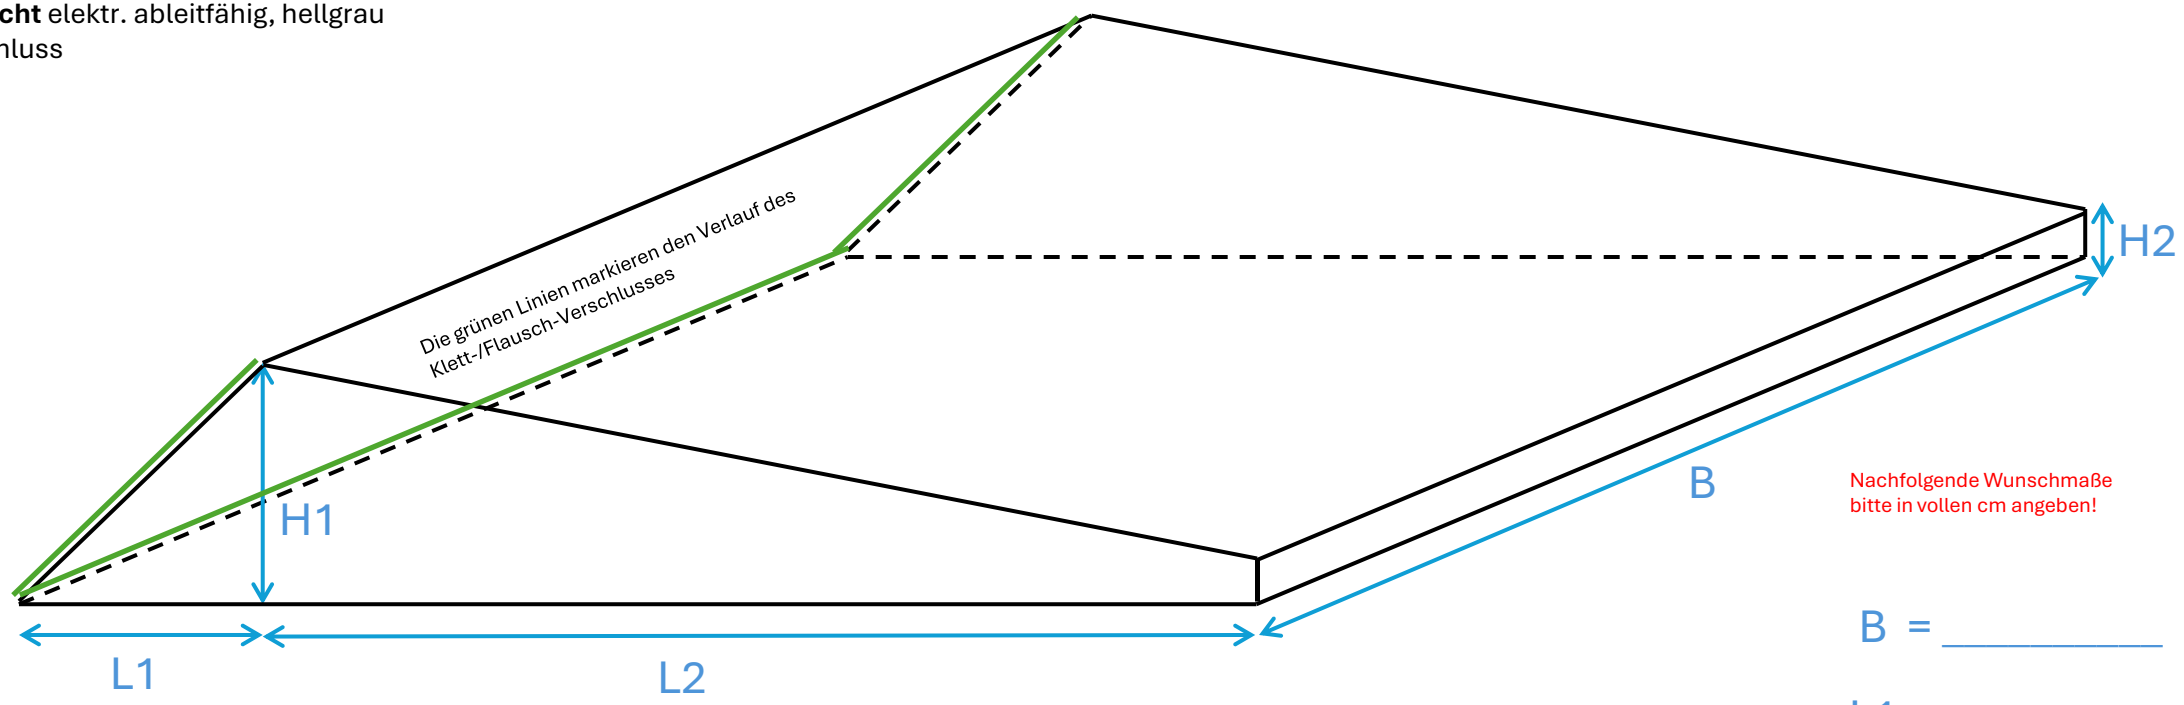

Nachfolgende Wunschmaße bitte in vollen cm angeben!

B = _____

L1 = _____

L2 = _____

H1 = _____

H2 = _____
mindestens 1cm:

Medstorm GmbH Koblenz
Tel: 0261 / 973 237 96
Mail: buero@medstorm.de
Rev24.3

Kunde/Einrichtung:

Funktion /Fachbereich

Datum / Unterschrift